



令和4年9月14日

株式会社アップドラフトに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

消費者庁は、本日、株式会社アップドラフト（以下「アップドラフト」といいます。）に対し、同社が供給する「滝風<sup>たき</sup>イオンメディック」と称する商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会（公正取引委員会事務総局東北事務所）の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令（別添参照）を发出了しました。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社アップドラフト（法人番号 9370001019036）  
所在地 仙台市太白区富沢南一丁目22番11号  
代表者 代表取締役 大城 雅樹  
設立年月 平成21年1月  
資本金 1000万円（令和4年9月現在）

2 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金対象行為（違反行為）に係る商品

「滝風イオンメディック」と称する商品（以下「本件商品」という。）

(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体

(ア) カタログ

(イ) 「Ameba」と称するウェブサイトにおける「滝風イオンメディック」と称する自社ブログ（以下「自社ブログ」という。）

イ 課徴金対象行為をした期間

令和元年5月1日から同年12月11日までの間

ウ 表示内容（別紙1ないし別紙4）

(ア) カタログ

別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品は2400万ions/cc以上のマイナスイオンを発生させ、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、6畳から最大80畳までの空間において、浮遊するインフルエンザウイルスを除去及び付着するインフルエンザウイルスを不活化する効果、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオ

ネラ菌を除菌する効果、アレルギー物質、浮遊ウイルスを分解、除去する効果並びに衣類の付着臭を分解、除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

(イ) 自社ブログ

- a 別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品は2400万ions/ccのマイナスイオンを発生させ、本件商品を使用すれば、白血球が大きくなって、免疫力が高くなる効果が得られるかのように示す表示をしていた。
- b 別表3「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品は2400万ions/ccのマイナスイオンを発生させ、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、最大80畳までの空間において、付着臭等を消臭する効果、血圧を下げる効果、電磁波を除去する効果、血流を促進する効果、活性酸素を除去する効果、関節炎を改善する効果、糖尿病を改善する効果、慢性肝炎を改善する効果、慢性腎不全を改善する効果及び動脈硬化症を改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
- c 別表4「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用すれば、室内に浮遊する花粉を吸着、除去する効果並びに花粉症による涙目、かゆみ、鼻水及びくしゃみを解消する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

エ 実際

前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、アップドラフトに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

オ 打消し表示

前記ウ(イ) bの表示について、「商品の体感、効果には個人差がございます。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウ(イ) bの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

(3) 課徴金対象期間

令和元年5月1日から令和2年6月8日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

アップドラフトは、本件商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠資料を有することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要（課徴金の額）

アップドラフトは、令和5年4月17日までに、2864万円を支払わなければならない。

【本件に対する問合せ先】

消費者庁表示対策課

電 話 03（3507）9239

ホームページ <https://www.caa.go.jp/>

## 表示内容

- ・「『滝風 ION MEDIC』はマイナスイオンの働きに着目しました。大自然さえも上回る2400万ions/cc以上のマイナスイオンを発生。」並びに青い円のイラストと共に、「自然の滝」及び「10,000ions/cc」、「滝風<sup>たき</sup> TAKI ION MEDIC」と記載の青い円のイラストと共に、「24,000,000ions/cc以上」
- ・「また、『滝風 ION MEDIC』は6畳から最大80畳まで対応できます。」
- ・「New インフルエンザウイルスの生存率を下げる事が実証されました。一般社団法人 北里環境科学センター調べ」、「浮遊インフルエンザウイルス除去試験 『滝風イオンメディック』のウイルス除去効果は、作動後15分間で対数減少値を示したことから、ウイルス除去効果があると判断されました。」、「経過時間ごとの浮遊ウイルス感染価（対数値）の変化」との記載と共に、「対照（自然減衰）」及び「滝風イオンメディック」のうち滝風イオンメディックについては、作動時間15分で「ウイルス感染価」が「検出限界値」と記載の箇所に至ったことを示す折れ線グラフ並びに「付着インフルエンザウイルス不活化試験 『滝風イオンメディック』のウイルス不活化効果は、作動後3時間で対数減少値を示したことから、ウイルス不活化効果があると判断されました。」、「時間経過によるウイルス感染価の変化」との記載と共に、「対照（自然減衰）」及び「滝風イオンメディック」のうち滝風イオンメディックについては、作動時間6時間で「ウイルス感染価」が「検出限界値」と記載の箇所に至ったことを示す折れ線グラフ
- ・「滝風イオンメディックが発生させるマイナスイオンは、雑菌を滅菌し、たばこやペット臭などの気になる匂いも取ります。」並びに「たった2時間で除菌！ ※株式会社日本微生物研究所にて試験（平成15年3月24日）」との記載と共に、「黄色ブドウ球菌」、「腸炎ビブリオ菌 サルモネラ菌」及び「レジオネラ菌」が「120分」と記載の箇所で「0」と記載の数値に至ったことを示す折れ線グラフ
- ・「最大80畳までOK！！」
- ・「『滝風イオンメディック』は除菌・浄化力が強力です！！」、「アレル物質・ウイルス分解・除去 お部屋のアレル物質・浮遊ウイルスを強力に分解・除去しますので、小さなお子様にも安心です。」及び「付着臭分解・除去 衣類に付いたイヤなニオイ成分を分解・消臭。梅雨時の部屋干し臭も吸着しないのでお部屋も、衣類もスッキリ。」

## 表示内容

「免疫力アップ!」、「免疫力とは体を病気から守る防御システム、その重要な役が血液中の『白血球』です。白血球は血流によって全身を巡回しながら体の中に侵入する異物を飲み込み、異常細胞を処理して病気から体を守る『免疫活動』を日夜行っています!」、「免疫活動を行うのは、白血球の細胞『マクロファージ』『顆粒球』『リンパ球』です。」、「この免疫活動を活発にする期待ができるのが『滝風イオンメディック』なんです!以前、血液画像分析センターで研究していただいた結果、滝風を吸引した後白血球が大きくなることがわかったのです!また自律神経のバランスも正常に落ち着いてくるので自然と白血球の活動が活発になるのです!つまり『免疫力』が高くなるということです。」及び「滝風イオンメディックからは驚異の2400万ion/ccの負電子が大量に発生しており大自然の空気以上の新鮮さをお部屋で体験できます!」

(別紙 2)

## 表示内容

- ・「松野：体感しやすいのは、消臭効果です。アンモニア溶液を染み込ませたティッシュをご用意しましたので、ちょっと嗅いでみてください。 ■■■：うっ！鼻を刺すようなニオイですね。 松野：このティッシュを、『滝風イオン』のイオン風に当てます。（約30秒後）では、もう一度ティッシュを嗅いでみてください。 ■■■：…すごいっ！アンモニア臭が完全になくなっている！多少はニオイが残っているかなと想像していましたが、これは驚きです【実験1】参照。」並びに「【実験1】消臭効果」、アンモニア溶液をスプレーでティッシュに噴霧する画像と共に、「←ティッシュにアンモニア溶液を染み込ませます。」、ティッシュを手にした人物の画像と共に、「↓念のために、ニオイを嗅ぎます。」、「鼻を刺すようなキツイニオイ！」及び「くっさー！！」、ティッシュを本件商品に当てた人物の画像と共に、「↑ティッシュにマイナスイオン風を30秒間当てます。」、ティッシュの臭いを嗅ぐ人物の画像と共に、「←再びティッシュのニオイを嗅ぎます。」及び「くんくん」、ティッシュを手にした人物の画像と共に、「本当にニオイがなくなった！」及び「すごい！！」
- ・「松野：続いて、血圧の変化を見てみましょう。この血圧計を着けてください。手首に巻く簡易タイプなので、健康診断で使う腕に巻くタイプと比べて、ちょっと数値が高く出やすいので、驚かないでくださいね。…上が194で、下が139ですね。 ■■■：あれ、ちょっと緊張しているのかな。確かに高めに出来ますね…（苦笑）。 松野：では、イオン風を吸ってください。（30分ほど、イオン風を吸う）では、もう一度測ってみましょう。…上が171で、下が115。2割弱落ちましたね【実験2】参照。 ■■■：ただ呼吸してただけなのに、不思議ですね…。いろいろと伺いたいことがありますが、今は我慢します（笑）。」及び「【実験2】血圧降下効果」、血圧計を手首に巻いた人物の画像と共に、「マイナスイオンによる血圧降下効果を見るために、手首に巻くタイプの血圧計を使いました。」、「吸う前」と記載した血圧計の画像と共に、「上が194で、下が139でした。対談で緊張されているのか、ちょっと高めでした。」、「吸った後」と記載した血圧計の画像と共に、「30分間ほどマイナスイオン風を吸った後、再計測。 上が171、下が115まで血圧が下がりました」
- ・「松野：はい（笑）。続いて、マイナスイオンによる電磁波への作用をご覧ください。ここに電磁波検知器とノートパソコンを用意しました。電源を入れなくても、コンセントにつなぐと、検知器から検知音が鳴ります。『滝風イオン』本体も同様です。 ■■■：はい。 松野：そこで、『滝風イオン』でマイナスイオンを発生させると、検知器は…。 ■■■：検知音が鳴りやみましたね。これはスゴイ！というより、本当に不思議ですねえ…【実験3】参照。」並びに「【実験3】電磁波除去」、本件商品、ノートパソコン及び電磁波検知器を手にした人物の画像と共に、「ノートパソコンに電磁波検知器を近づけると… ↓ ピッピッピッ」、「電源が入ってなくても、コンセントが繋がってれば、ノートパソコンや『滝風イオンメディック』に電磁波検知器を近づけると『ピッピッ』と検知音が鳴ります。」、並びにスイッチを入れた本件商品、ノートパソコン及び電磁波検知器を

手にした人物の画像と共に、『滝風イオンメディック』の電源を入れた途端に ↓ ……、  
「マイナスイオンの生成を始めると、ノートパソコンや『滝風イオンメディック』本体に  
検知器を近づけても、検知音が鳴らなくなりました。」

- ・「【消臭効果】…マイナスイオンには、ニオイ成分を分解する作用があります。アンモニア溶液が染み込んだティッシュにマイナスイオンを当てたことで、ニオイ成分が分解、消臭されたというわけです。」
- ・「【血圧降下効果】…血圧が高くなる原因の一つに、いわゆるドロドロ血液があります。もともと、血液に含まれている赤血球はマイナスの電気を帯び、お互いが反発し合って、くっつくことはありません（つまり、血流が良い状態で保たれる）。ところが、空気環境が悪い場所にいたり、ストレス・疲労を溜めたりすると、次第にプラスに帯電する赤血球が生まれ、お互いがくっつき、ドロドロ血液になってしまいます（これが高血圧の原因となる）。そこで、大量のマイナスイオンを浴びると、プラスの赤血球が、再びマイナスの赤血球に戻り、血流がスムーズになります。その結果、血圧が下がるのです。実際、医師の協力のもとで行なった試験では、被験者全員に、『ドロドロ血液が改善した』という結果が得られました【実験4】参照。」並びに「【実験4】血液サラサラ効果」、「ドロドロ血液の方に、『滝風イオンメディック』で作ったマイナスイオンを10分間吸入してもらい、血液の変化を観察しました。その結果、いずれも血液の状態が改善されて、サラサラ血液に。また、白血球が活性化するなどの変化が確認されました。」、「41歳女性」、「45歳女性」、「30歳男性」、「吸う前」及び「10分後」と記載した血液の状態をそれぞれ示す画像と共に、「赤血球の塊が正常な状態に戻りました！」及び「検査機関：東京八重洲メディカルクリニック（XXXXXXXXXX医師）」
- ・「【電磁波除去】…2400万個/ccという、超高濃度のマイナスイオンが電磁波に作用したと考えています。付け加えれば、『ドロドロ血液の改善』も、この延長線上にあります。」
- ・本件商品の画像と共に、「80畳まで対応」、「吸うだけで元気になる『空気』を作り出す!」、「一つひとつは力の弱いイオンでも、2400万個/ccという膨大な量になると、素晴らしい還元作用を発揮します。」及び「『滝風イオンメディック』の効果 ▶活性酸素の除去 ▶関節炎 ▶糖尿病 ▶慢性肝炎 ▶慢性腎不全 ▶動脈硬化症」

(別紙3)

## 表示内容

本件商品の画像と共に、「…TAKI ION MEDIC (医療用物質生成器)は常に室内の空気をきれいにし自己の免疫力を高め正常な免疫力を保つことで花粉症の発症を防いだり緩和することが期待できます。また室内に浮遊する花粉を吸着、除去と室内の見張り番に是非1台」、及び本件商品の画像と共に、「滝風イオンメディックの前で呼吸すると涙目 かゆみ 鼻水 くしゃみが解消！」

(別紙 4)

UPDRAFT

これからは  
空気を選ぶ  
時代なのよ。

滝たき風

TAKI ION MEDIC®

医療用物質生成器

美川憲一

ION  
認・定  
137-B020  
番・号  
APPROVAL  
ASSOCIATION OF ION RESEARCH AND APPLICATION


認定：2015年10月  
JIS-B-9929に基づいた  
測定により、イオン発生(クラス6)  
が認められました。

イオン発生  
密度もNo1

JIS(日本工業規格)による発生密度測定(JIS-B9929)において最高密度を表す“クラス6”の認定を日本機能性イオン協会より平成27年10月正式に滝風イオンメディックが認定された。



# 無垢の空気 溶け込む“やすらぎ” 優しい力で大きな働き

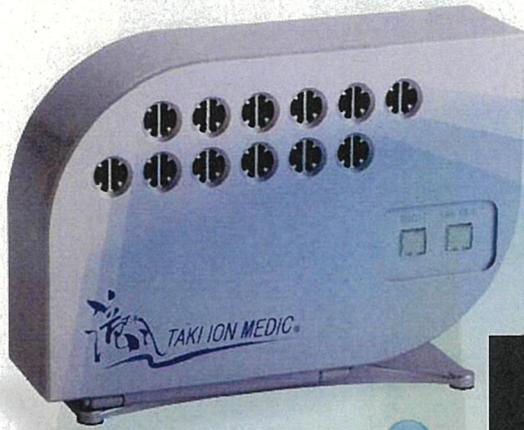

ライトパープル



## これがマイナスイオンの力

自然の中、とくに滝やせせらぎのそばの空気は清々しく感じます。そのワケは、空気中にマイナスイオンが多く含まれているからです。マイナスイオンは、心身のリラックスはもちろん、除菌・脱臭・集塵にも最適です。マイナスイオンは、「空気のビタミン」ともいわれ、生物に欠かすことのできない大切な空気中の要素です。「滝風 ION MEDIC」はマイナスイオンの働きに着目しました。大自然さえも上回る2400万ions/cc以上のマイナスイオンを発生。しかもプラスイオンは全く出ていません。テレビなどの電化製品によって増加した、身体に悪影響を与えるプラスイオンを中和し、まるで森林浴をしているようなやすらぎを部屋の中に広げます。また、「滝風 ION MEDIC」は6畳から最大80畳まで対応できます。

自然の滝



10,000ions/cc



24,000,000ions/cc以上

New


## インフルエンザウイルスの生存率を 下げる事が実証されました。

一般社団法人 北里環境科学センター調べ

### 浮遊インフルエンザウイルス 除去試験

「滝風イオンメディック」のウイルス除去効果は、作動後15分間で対数減少値を示したことから、ウイルス除去効果があると判断されました。


#### 経過時間ごとの浮遊ウイルス 感染価(対数値)の変化

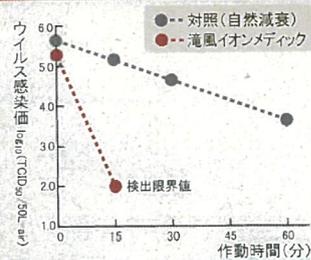

### 付着インフルエンザウイルス 不活化試験

「滝風イオンメディック」のウイルス不活化効果は、作動後3時間で対数減少値を示したことから、ウイルス不活化効果があると判断されました。

#### 時間経過によるウイルス 感染価の変化

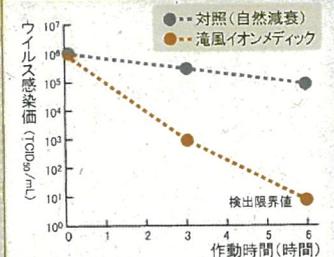


自然の滝の近くにいるような心地よさを体感してください。

脱臭・除菌・健康・環境エコロジー対策として  
マイナスイオンには脱臭・除菌・集塵、健康に効果があります。  
滝風イオンメディックが発生させるマイナスイオンは、雑菌を滅菌し、タバコやペット臭などの気になる匂いも取ります。

## たった2時間で除菌!

※株式会社日本微生物研究所にて試験（平成15年3月24日）

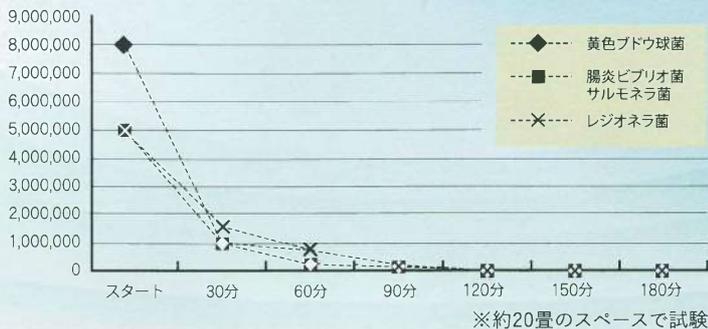

ecology & High power

フィルターの交換がありません  
(経済的)

お手入れは誰でもカンタン!

最大80畳までOK!!

気になる電気代は1ヶ月90円  
(1日約3円)

移動もカンタン  
片手で移動!!




# 「滝風イオンメディック」は除菌・浄化力が強力です!!



最大級のイオン発生量  
イオンターボチャージャー方式を採用  
イオンターボチャージャー方式により、やわらかなイオンが大量に発生し部屋中を自然の空間に演出します。

[平成17年7月28日商標登録済]

TAKI ION MEDIC



## アレル物質・ウイルス分解・除去

お部屋のアレル物質・浮遊ウイルスを強力に分解・除去しますので、小さなお子様にも安心です。


TAKI ION MEDIC



## 付着臭分解・除去

衣類に付いたイヤなニオイ成分を分解・消臭。梅雨時の部屋干し臭も吸着しないのでお部屋も、衣類もスッキリ。

TAKI ION MEDIC



## 静電気(帯電)防止・除去対策に

電化製品に囲まれている私たちの生活が体調不良の原因と言われています。帯電を除去し静電気による不快感を解消します。

TAKI ION MEDIC



**TAKI  
ION  
MEDIC**

**製品仕様** Specification

品名	医療用物質生成器 滝風ION MEDIC
外形寸法	W300×D79.5×H220(mm)
本体材料	難燃ABS (UL94 V-0)
重量	1,700g
電源	AC100V (50/60Hz共用)
消費電力	10W
放電方式	コロナ無声放電 (イオンターボチャージャー方式)
発生イオン濃度	200万ions/cc以上×12 (各吹き出し口)
発生オゾン濃度	0.020 ppm以下 (室内の湿度により 多少の変動があります)

Made in JAPAN

現金販売  
価格 **¥240,000**

上記金額には、消費税が含まれており  
ません。別途消費税が加算されます。



商標登録済 登録第 5821474 号  
商標登録済 登録第 5821475 号

NPO LUDPAK 総経番号 B-0179  
生活習慣病予防学術委員会登録

(NPO法人)  
予防医学・代議定書審判協会  
認定品

この商品の省エネ性能は ★★★★★

⚠️ 安全に関するご注意

※ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使い下さい。  
※燃焼器具と併用してご使用になる場合は、換気を行って下さい。

⚠️ 使用上のご注意

※覆室や、深夜等でかすかな運転音が気になる場合は「HIGHモード」スイッチをOFFしていただくこと快適にご使用いただけます。



滝風イオンメディックロゴ及びイオンメディック、ION MEDICは、株式会社アップドラフトの登録商標です。



最近「滝風イオンメディック」に酷似した類似商品が多数販売されております。これらの類似品は粗悪品であり「滝風イオンメディック」では御座いませんので、販売店にご確認のうえご購入くださいませ。



**UPDRAFT**

<https://takiion.co.jp/>

総発売元 **株式会社 アップドラフト**®

〒982-0036 仙台市太白区富沢南1丁目22-11 1F

TEL.022-304-1022 FAX.022-304-1023



■ お問い合わせは

送料/クロネコヤマト又は佐川急便にて送料無料。ただし、返品につきましては、お客様ご負担となります。代引手数料は無料です。  
返品可能期間/商品到着後8日以内  
保障期間/ご購入より1年。修理が必要とされる場合は早急に対応いたします。また、万一、お送りした商品に不良品がございましたら、直ちに新品と交換させていただきます。  
引渡時期/ご注文後、2~5日以内にお届けいたします。(在庫がない場合は、お届けまで2週間かかりますので、ご確認のうえ、ご注文をお願い致します。)  
お支払方法/クロネコヤマトによる商品代引き・銀行振込

Ameba ホーム ビグ アメブロ

滝風イオンメディック 公式ブログ『株式会社アップドラフト』

株式会社アップドラフトTAKI ION MEDIC 社長ブログ

滝風イオンメディックで  
安心 安全 快適生活

『これからは空気を選ぶ時代なのよ』

ブログトップ 記事一覧 画像一覧

このブログを検索する

プロフィール

< イオンメディック 先生監修 |... >


## 免疫力アップ!

2016-03-23 17:36:33

テーマ:健康 快適生活

免疫力とは体を病気から守る防御システム、その重要な役が血液中の『白血球』です。

白血球は血流によって全身を巡回しながら体の中に侵入する異物を飲み込み、異常細胞を処理して病気から体を守る『免疫活動』を日夜行っています!

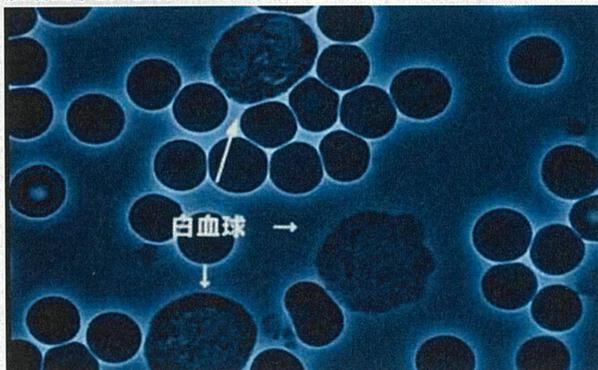

免疫活動を行うのは、白血球の細胞『マクロファージ』『顆粒球』『リンパ球』です。



イオン坊や

プロフィール | ビグの部屋

全体ブログランキング 38,232位 ↓  
その他の企業・団体ジャンル 305位 ↓

+フォロー

AD

最新の記事

愛用者の集い  
ご購入の前に  
嶋さんお疲れ様!  
空気感染  
滝風イオンセミナーin直方  
メルカリにて盗難品です  
紅葉シーズン  
泥だらけの滝風  
よくあること

TAKI ION MEDIC

一覧を見る

テーマ

ブログ (337)

グルメ 食べ歩き (35)



この免疫活動を活発にする期待ができるのが『滝風イオンメ  
ディック』なんです!以前、血液画像分析センターで研究してい  
ただいた結果、滝風を吸引した後白血球が大きくなることがわ  
かったのです!また自律神経のバランスも正常に落ち着いてく  
るので自然と白血球の活動が活発になるのです!  
つまり『免疫力』が高くなるということです。



滝風イオンメディックからは驚異の2400万ion/ccの負電子が  
大量に発生しており大自然の空気以上の新鮮さをお部屋で体  
験できます!

- 滝風ion medic (213)
- 松山千春 (1)
- 滝風イオンメディック (365)
- 偽物 です! (4)
- お客様の声 (13)
- 楽天イーグルス (18)
- 取引停止 (1)
- 美術協力 (2)
- CORORION (11)
- 美川憲一 (1)

[一覧を見る](#)

カレンダー

◀ 2019年11月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

月別


- 2019年田
- 2018年田
- 2017年田
- 2016年田
- 2015年田
- 2014年田
- 2013年田
- 2012年田
- 2011年田
- 2010年田
- 2008年田

[一覧を見る](#)

このブログを検索する




このブログのフォロー

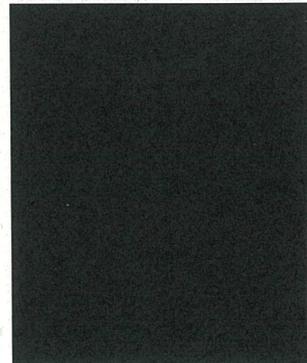



何時でも無理なく誰でも簡単に  
使える滝風(たき)イオンメディックをあなたの近くに…

株式会社 アップドラフト  
<http://updraft-ion.co.jp>

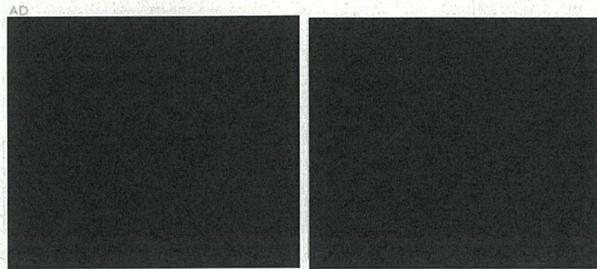

いいね! 3    リブログする

いいねした人一覧

B! ブックマーク 0    ツイート    シェア 0

イオン坊やさんをフォロー  
ブログの更新情報が受け取れて、アクセスが簡単になります  
+フォロー



前の記事    次の記事  
イオンメディック    先生監修!!...

ブログトップ    記事一覧    画像一覧

フォロワー: 62 人

+フォロー

お気に入りブログ




一覧を見る

ブックマーク

RSS

著作権についてのご注意



# 滝風イオンメディック 公式ブログ『株式会社アップドラフ

株式会社アップドラフトTAKI ION MEDIC 社長ブログ

滝風イオンメディックで  
安心 安全 快適生活

『これからは空気を選ぶ時代なのよ』

📖 ブログトップ

📄 記事一覧

📷 画像一覧

◀ [REDACTED] 先生が…

自律神経と滝風イオン ▶



2018-04-17 08:30:00

テーマ: 滝風ion medic

月刊 [REDACTED] に滝風イオンメディックが特集として [REDACTED] 社長との対談で表紙から登場しました。

May  
5月号

**対談**  
株式会社 アップドラフト  
代表取締役社長  
**松野 雅樹** ×

「本物は違う」ということを実感  
**世界一のマイナスイオン発生器**

**特集** **しないとマズイ  
電磁波対策**

骨芽細胞の産生を促進  
カルシウムを超えた新素材  
血管の安定が長寿を実現  
ゴースト血管を修復!  
薬でダメだった人に効いている  
「爽快でるでる」体験談特集

この対談で 社長は滝風イオンメディックの凄さを体感され  
早速導入!

# 対談

第135回

## 「本物は違う」ことを実感しました！ 世界一のマイナスイオン発生器

「世界一のマイナスイオン発生器」を開発された方に会える機会、楽しみにしておりました。  
松野雅樹(以下「松野」) 地元、宮城県を拠点に、16年間、ゴッソッと活動してきました。

松野「医師の書



医師

それが先日、医師の書  
籍で「滝風イオンメディック」以  
下「滝風イオン」が取り上げら  
れたのを機に、一気にお問い合わせが増えました。


松野「ひどい花粉症だったので、  
が、15分ほど「滝風イオン」のス  
イッチを入れたまま説明していま  
したら、あれ、涙と鼻水が止まっ  
た」と仰ったのです。

で「台ご購入され、「こんな素晴らしい商品はもって世に広めたい」と、書籍に取り上げていただいたというわけです。  
「これはもう、細かなお話を伺う前に、実際に体験した方が早そうですね。」

松野「医師が、ベタ褒めと云っているのは「滝風イオン」を絶賛されていたんですね。」  
松野「医師が、ベタ褒めと云っているのは「滝風イオン」を絶賛されていたんですね。」


松野「体感しやすいのは、消臭効果です。アンモニア溶液を染み込ませたティッシュをご利用しましたので、ちよっと嗅いでみてください。」

松野「このティッシュを、「滝風イオン」のイオン風に当てます。(約30秒後)では、もう一度ティッシュを嗅いでみてください。」

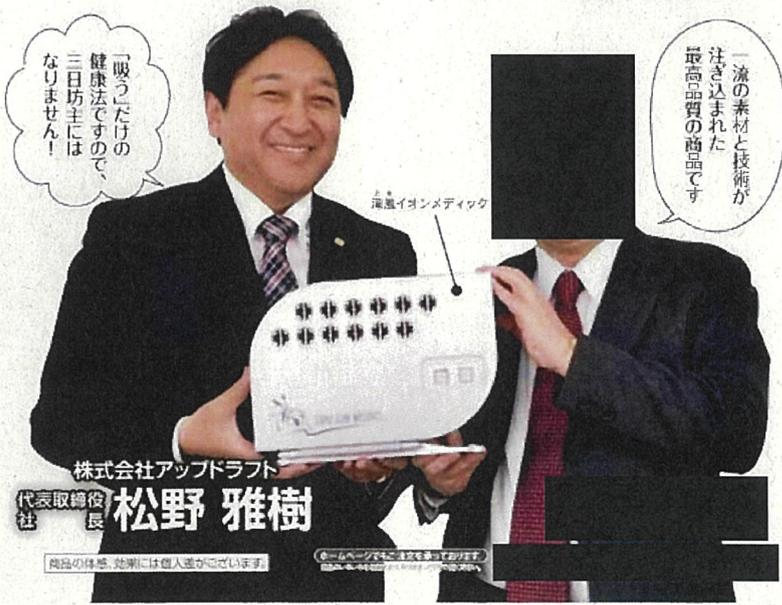

一流の素材と技術が注ぎ込まれた最高品質の商品です  
「吸っただけで健康法ですので、三日坊主にはなりません！」  
株式会社アップドラフト 代表取締役社長 松野 雅樹  
簡単なデモンストレーションを見ていただき驚いた様子の社長！

**【実験1】消臭効果**

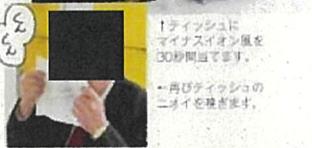

**【実験2】血圧降下効果**



マイナスイオンによる血圧降下効果を見るために、手首に巻くタイプの血圧計を使いました。

上が194で、下が139でした。対称で緊張感を感じているのか、ちよつと高めでした。  
※上腕に巻く血圧計と比べて、1割ほど高く出るそうです。



30分間ほどマイナスイオン風を吸った後、再計測。  
上が171、下が115まで血圧が下がりました



**【実験3】電磁波除去**



電源が入っていないなくても、コンセントが繋がってれば、ノートパソコンや「滝風イオンメディック」に電磁波検知器を近づけると「ビッピッ」と検知音が鳴ります。

ところが...



マイナスイオン生成も始める。ノートパソコンや「滝風イオンメディック」は電磁波検知器を近づけても、検知音が鳴らなくなりました。

「...すこいっ！アンモニア臭が完全になくなっている！多少はニオイが残っているかなど想像していましたが、これは驚きです！【実験1】参照。」  
松野は続いて、血圧の変化を見てみましよう。この血圧計を着けてください。手首に巻く簡易タイプなので、健康診断で使う腕に巻くタイプと比べて、ちよつと数値が高く出やすいので、驚かないでください。上が194で、下が139ですね。  
「あれ、ちよつと緊張しているのかな。確かに高めに出来ますね。【苦笑】」  
松野には、イオン風を吸ってください。  
（30分ほど、イオン風を吸う）  
では、もう一度測ってみましよう。上が171で、下が115。2割削減しましたね【実験2】参照。  
「ただ呼吸していただけなのに、不思議ですね。いろいろ伺いたいことがあります。今は我慢します【笑】。」  
松野は「はい【笑】」と、続いて、マイナスイオンによる電磁波への作用を伺いたがります。  
ここに電磁波検知器とノートパソコンを用意しました。電源を入れなくても、コンセントにつなぐと、検知器から検知音が鳴ります。「滝風イオン」本体も同様です。

04 ご注文は 通話料無料・今すぐお電話で ▶▶▶

4月21日(土) 22日(日) パシフィック横浜会議センターにて開催される『』に滝風イオンメディックのブースが登場します。

はい。松野「そこで『滝風イオン』でイナスイオンを発生させると、検知器は...

世界一のマイナスイオン効果



松野社長、もうそろそろ限界です。詳しい解説をお願いします。松野「わかりました(笑)。

【消臭効果】：マイナスイオンには、二オイ成分を分解する作用があります。アンモニア溶液が染み込んだティッシュにマイナスイオンを当てたことで、二オイ成分が分解、消臭されたというわけです。

【血圧降下効果】：血圧が高くなる原因の一つに、いわゆるドロドロ血液があります。もともと血液に含まれている赤血球はマイナスの電気を帯び、お互いが反発し合っ...

ところが、空気が乾燥している場所だったり、ストレス、疲労を溜めたりすると、次第にプラスに帯電する赤血球が生まれ、お互

検知音が鳴りやみましたね。これはスコイというより、本当に不思議ですねえ。【実験3】参照。

いがかつつき、ドロドロ血液になつてしまいます(これが高血圧の原因となる)。

そこで、大量のマイナスイオンを浴びると、プラスの赤血球が、再びマイナスの赤血球に戻り、血液がスムーズになります。その結果、血圧が下がります。

【電磁波除去】：24時間/24時間という、超高濃度のマイナスイオンが電磁波に作用したと考...


【非常に重要なものほど役に立つ】という一念で商品を開発!

松野「松野社長の前職は歯科技師だったと伺っています。なぜ、独立して、『滝風イオン』を開発しようと思われたのですか。

松野「歯科技師士を目指したのは、小さい頃から手先が器用で、モノづくりが好きだったからです。実を言え...

【実験4】血液サラサラ効果

ドロドロ血液の方に、『滝風イオンメディック』で作ったマイナスイオンを10分間吸入してもらい、血液の変化を観察しました。その結果、いずれも血液の状態が改善されて、サラサラ血液に、また、白血球が活性化するなどの変化が確認されました。

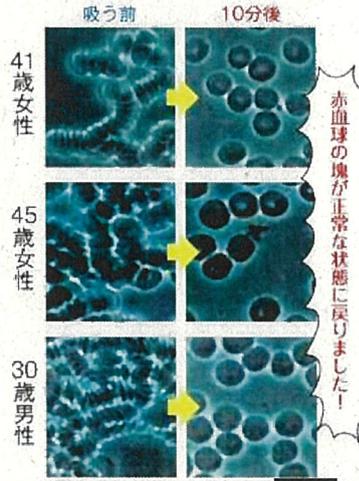

赤血球の塊が正常な状態に戻りました!

【実験4】血液サラサラ効果

【非常に重要なものほど役に立つ】という一念で商品を開発!

【非常に重要なものほど役に立つ】という一念で商品を開発!

【非常に重要なものほど役に立つ】という一念で商品を開発!

商品の体験、効果には個人差がございます。 ホームページをご覧ください。

こちらの会場では簡単なデモンストレーションや詳しい説明をさせていただきます。

ご購入を悩んでいる方、不安な方 詳しく納得するまでスタッフがご説明いたします。

<http://updraft-ion.co.jp> お問い合わせからお願いいたします。

### 唯一無二の マイナスイオン発生「針」

一見すると同じような「針」に見えますが、安定して大量のマイナスイオンを発生させるために、高品質の素材と技術を凝縮込めています。



ヨーロッパの医療用マイナスイオン針、中国製のマイナスイオン針、日本製のマイナスイオン針



「海風イオンメディック」はプロ野球球団にも導入されています。写真に、福岡ソフトバンクとして活躍する松野社長。

「C社の工場で作ったことで、「海風イオン」ほどのような進歩を遂げたのでしょうか。松野：マイナスイオンを発生する際に放電する「針」の品質が格段に上がりました。安い中国製では、板状の金属を針状にくり抜いただけで作ら

### 品質へのこだわりが 唯一無二の商品を生んだ!



が整った工場で作った方がよい」というアドバースとともに、大手家電メーカーC社の工場を紹介してくださったのです。松野：「これまた日本有数の技術を持ったメーカーですね。それにしても、苦勞話を伺えると、思ったら、ほとんど拍子で「海風イオン」は売れていた。松野：「いえいえ、本当の苦勞はこ

こからでした(笑)。町工場で作った第一号機の視点はC社の工場に受け入れてもらえず、素材や金型など全部見直すことになりました。その結果、販売ルートがないのに多額の借入金を抱えるという事態に陥り、軌道に乗るまで6年かかりました。

「一般的に、中小企業が大手と手を組むと、技術だけ持って行かれてしまうという話をよく聞きます。しかし「海風イオン」の場合は、松野社長の「品質へのこだわり」が大手を動かしました。違う状況を作り出したのだと思います。その結果、既存技術であるマイナスイオンが、新しい健康商品として生まれ変わったのです。

「松野：「松野社長は、品質へのこだわりが、大手を動かしました。一般的に、中小企業が大手と手を組むと、技術だけ持って行かれてしまうという話をよく聞きます。しかし「海風イオン」の場合は、松野社長の「品質へのこだわり」が大手を動かしました。違う状況を作り出したのだと思います。その結果、既存技術であるマイナスイオンが、新しい健康商品として生まれ変わったのです。」

「松野：「松野社長は、品質へのこだわりが、大手を動かしました。一般的に、中小企業が大手と手を組むと、技術だけ持って行かれてしまうという話をよく聞きます。しかし「海風イオン」の場合は、松野社長の「品質へのこだわり」が大手を動かしました。違う状況を作り出したのだと思います。その結果、既存技術であるマイナスイオンが、新しい健康商品として生まれ変わったのです。」

「松野：「松野社長は、品質へのこだわりが、大手を動かしました。一般的に、中小企業が大手と手を組むと、技術だけ持って行かれてしまうという話をよく聞きます。しかし「海風イオン」の場合は、松野社長の「品質へのこだわり」が大手を動かしました。違う状況を作り出したのだと思います。その結果、既存技術であるマイナスイオンが、新しい健康商品として生まれ変わったのです。」

**80畳**  
まで対応

医療用物質生成器 **海風イオンメディック**

**259,200円(税込)**

- サイズ：幅300×奥行79.5×高さ220mm ●重量：約1700kg
- 稼働方式：コロナ様式放電(イオン発生方式)
- 発生イオン濃度：2007ions/cc以上(2ヶ所)
- 発生イオン濃度：0.02ions/cc以下(室内の奥地に多い)
- 定格消費電力：10W ●電源：AC100V(50/60Hz)
- 特長：日本製 ●保証：1年間

## 吸うだけで元気になる 「空気」を作り出す!

一つひとつは力の強いイオンでも、2400万個/ccという高濃度にすると、素晴らしい還元作用を発揮します。ただ呼吸するだけでいいので、体力の衰えたお年寄りをはじめ、どなたでもお使いいただけます。

▶ 活性酸素の除去

▶ 関節炎 ▶ 慢性肝炎

▶ 糖尿病 ▶ 慢性腎不全

▶ 動脈硬化症

● 使い方

● メンテナンス方法

電源スイッチを入れるとイオン生成を開始します。

背面のボタンを押してカバーを外します。その上で、掃除などでイオン発生針を掃除してください。

06 ご注意は 通話料無料・今すぐお電話で

Ameba ホーム ビグ アメブロ

Ameba新規登録(無料)

▼ 芸能人ブログ ★ 人気ブログ

## 滝風イオンメディック 公式ブログ『株式会社アップドラフト』

株式会社アップドラフトTAKI ION MEDIC 社長ブログ

滝風イオンメディックで  
安心 安全 快適生活

『これからは空気を選ぶ時代なのよ』

ブログトップ 記事一覧 画像一覧

このブログを検索する

< 2016健康博覧会 [ ] のセレクトシ… >

### 花粉症対策はクスリor滝風？

2016-03-15 18:04:42  
テーマ:滝風ion medic

国民の20%に花粉症の症状がみられ今や国民病になりつつある花粉症!皆さんはいかがでしょうか?



風が吹いたり、天気の良い日は大変ですね…(@\_@)  
TV CMでもたくさんのアレルギー専用薬がひっきりなしに出ています!最近は…

#### プロフィール



イオン坊や

プロフィール | ビグの部屋

全体ブログランキング 19,185位 ↑  
その他の企業・団体ジャンル 103位 ↑

+ フォロー

AD



#### 最新の記事

コロリオンクラス5記念  
"劇場版コードブルー"  
CORORION in 中尊寺  
CORORION クラス5達成記念  
測定結果!!  
迷い  
楽天イーグルス



アレジオン(第2類医薬品)なんか効きそうなパッケージデザイン(笑)

医療用と同量配合…の文字に弱い日本人(^^;)



こちら アレグラFX(第1類医薬品) はネットではNo.1の人気で、薬剤師がいる薬屋のみで販売です。クスリで良くなったり緩和するのはいいのですが服用後の色々な副作用の可能性が高いということです!できれば副作用の無い……(^^)



…TAKI ION MEDIC(医療用物質生成器)は常に室内の空気をきれいにし自己の免疫力を高め正常な免疫力を保つことで花粉症の発症を防いだり緩和することが期待できます。また室内に浮遊する花粉を吸着、除去と室内の見張り番に是非1台

九州にて。

事務所の前で。

[一覧を見る](#)

テーマ

ブログ (339)

グルメ 食べ歩き (35)

健康 快適生活 (38)

滝風ion medic (214)

松山千春 (1)

滝風イオンメディック (372)

偽物 です! (4)

お客様の声 (13)

楽天イーグルス (20)

取引停止 (1)

美術協力 (2)

CORORION (13)

美川憲一 (1)

[一覧を見る](#)

カレンダー

2019年 12月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

月別

[2019年 田](#)

[2018年 田](#)

[2017年 田](#)

[2016年 田](#)

[2015年 田](#)

[2014年 田](#)

[2013年 田](#)

[2012年 田](#)

[2011年 田](#)

[2010年 田](#)

[2008年 田](#)

[一覧を見る](#)



滝風イオンメディックの前で呼吸すると涙目 かゆみ 鼻水 くしゃみが解消!

只今花粉症に関する体験談を募集中です。詳しくは株式会社アップドラフトまで御連絡をお願いします。

<http://updraft-ion.co.jp>

AD

いいね! 4      リブログする

いいね!した人一覧

BIブックマーク 0   ツイート   シェア 0

イオン坊やさんをフォロー  
ブログの更新情報が受け取れて、アクセスが簡単になります

+フォロー

< 2016健康博覧会      のセレクトショップ(…      >

同じテーマ「滝風ion medic」の記事

”劇場版コードブルー”  
2019-12-07   4

メルカリにて盗難品です  
2019-11-07   6


ごめんなさい。  
2019-09-12

もっと見る

画像つき記事

このブログを検索する

このブログのフォロワー

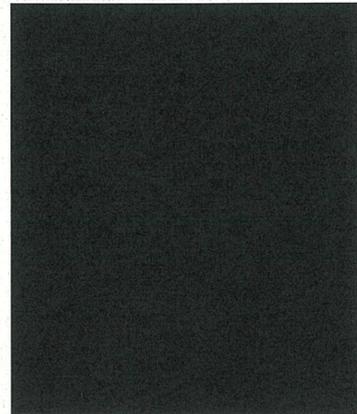


一覧を見る

フォロワー: 67 人

+フォロー

お気に入りブログ

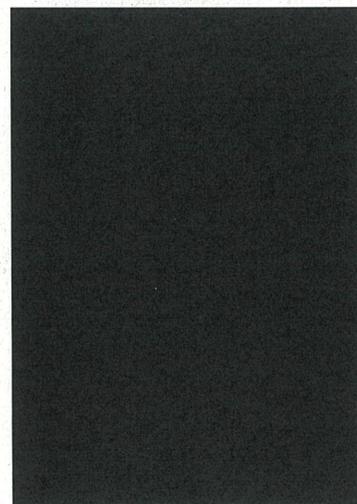

一覧を見る

ブックマーク

RSS

著作権についてのご注意

## ○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）

（昭和三十七年法律第百三十四号）

### （目的）

**第一条** この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

### （不当な表示の禁止）

**第五条** 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

- 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実と相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
- 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
- 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

### （措置命令）

**第七条** 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

- 一 当該違反行為をした事業者
  - 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
  - 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
  - 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
- 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

### （課徴金納付命令）

**第八条** 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

- 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事実と相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示
  - 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること又は事実と相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示
- 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。
- 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。

#### （課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額）

**第九条** 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。

#### （返金措置の実施による課徴金の額の減額等）

**第十条** 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付する措置（以下この条及び次条において「返金措置」という。）を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置（以下この条において「実施予定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実施予定返金措置計画」という。）を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。

- 2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  - 一 実施予定返金措置の内容及び実施期間
  - 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の方法に関する事項
  - 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
- 3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。
- 4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置

- を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。
- 5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。
    - 一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
    - 二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定の者について不当に差別的でないものであること。
    - 三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内閣府令で定める期間内に終了するものであること。
  - 6 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
  - 7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。
  - 8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるときは、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において単に「認定」という。）を取り消さなければならない。
  - 9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
  - 10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じることができない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。

**第十一条** 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。

- 2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認めるときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載されている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところにより計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものとする。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。
- 3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。

**（課徴金の納付義務等）**

**第十二条** 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計

算した課徴金を納付しなければならない。

- 2 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 3～6 (省略)
- 7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。

#### (報告の徴収及び立入検査等)

**第二十九条** 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

- 2～3 (省略)

#### (権限の委任等)

**第三十三条** 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任する。

- 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。
- 3 (省略)
- 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。
- 5～11 (省略)

## ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）

(平成二十一年政令第二百十八号)


#### (消費者庁長官に委任されない権限)

**第十四条** 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による権限とする。

#### (公正取引委員会への権限の委任)

**第十五条** 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十九条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

## 景品表示法による表示規制の概要

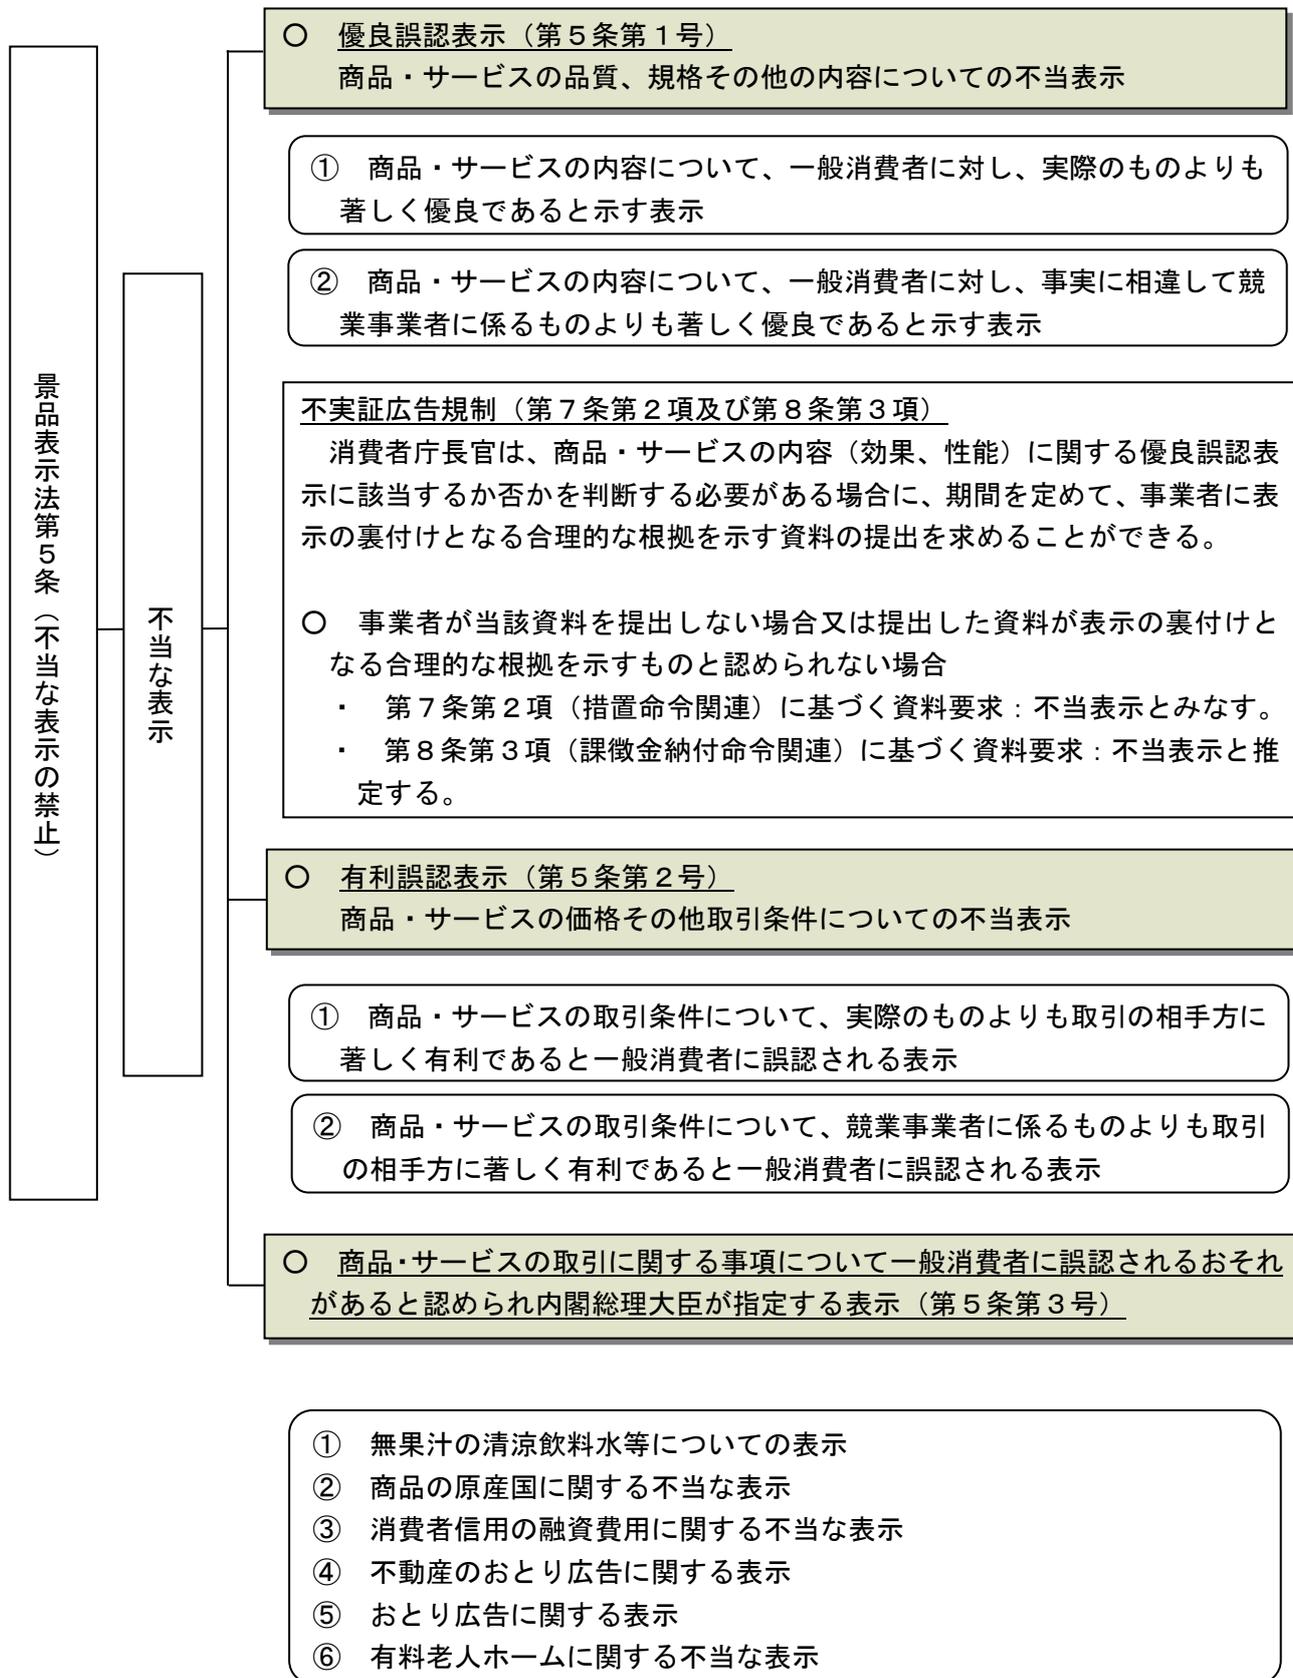

## 課徴金制度の概要

**目的** 不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入する。また、被害回復を促進する観点から返金による課徴金額の減額等の措置を講ずる。

### 課徴金納付命令 (第8条)

・対象行為：優良誤認表示行為、有利誤認表示行為を対象とする。

〔不実証広告規制に係る表示について、一定の期間内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合には、当該表示を優良誤認表示と推定して課徴金を賦課する。〕

- ・課徴金額の算定：対象商品・役務の売上額に3%を乗じる。
- ・対象期間：3年間を上限とする。
- ・主観的要素：違反事業者が不当な表示であることを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金を賦課しない。
- ・規模基準：課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しない。

### 課徴金対象行為が該当事実の報告による課徴金額の減額 (第9条)

課徴金対象行為に該当する事実を報告した事業者に対し、課徴金額の2分の1を減額する。

### 除外期間 (第12条第7項)

違反行為をやめた日から5年を経過したときは、課徴金を賦課しない。

### 賦課手続 (第13条)

違反事業者に対する手続保障として、弁明の機会を付与する。

### 返金措置の実施による課徴金額の減額 (第10条・第11条)

事業者が所定の手続に沿って返金措置を実施した場合は、課徴金を命じない又は減額する。

※返金措置＝対象商品・役務の取引をしたことが特定される一般消費者からの申出があった場合に、当該申出をした一般消費者の購入額に3%を乗じた額以上の金銭を交付する措置。

#### 1: 実施予定返金措置計画の作成・認定

返金措置を実施しようとする事業者は、実施予定返金措置計画を作成し、消費者庁長官の認定を受ける。

#### 2: 返金措置の実施

事業者は、実施予定返金措置計画に沿って返金措置を実施する。

#### 3: 報告期限までに報告

返金措置における金銭交付相当額が課徴金額未満の場合  
返金措置における金銭交付相当額が課徴金額以上の場合

課徴金額の減額

課徴金の納付を命じない

### 制度開始日

平成28年4月1日

※別添写しについては、添付を省略しています。

別添

消表対第1166号

令和4年9月14日

株式会社アップドラフト

代表取締役 大城 雅樹 殿

消費者庁長官 新井 ゆたか

(公印省略)

不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令

貴社は、貴社が供給する「滝風イオンメディック」と称する商品（以下「本件商品」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。）第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。

#### 主 文

株式会社アップドラフト（以下「アップドラフト」という。）は、課徴金として金2864万円を令和5年4月17日までに国庫に納付しなければならない。

#### 理 由

##### 1 課徴金対象行為

別紙記載の事実によれば、アップドラフトが自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、景品表示法第8条第3項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違反するものである。

##### 2 課徴金の計算の基礎

(1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品である。

イ(ア) アップドラフトが前記1の課徴金対象行為をした期間は、令和元年5月1日から令和元年12月11日までの間である。

(イ) 本件商品について、アップドラフトが前記1の課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から6月を経過する令和2年6月11日までの間に最後に取引をした日は、令和2年6月8日である。

(ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、前記1の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、令和元年5月1日から令和2年6月8日までの間である。

ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るアップドラフトの売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第1条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、9億5474万3358円である。

エ アップドラフトは、本件商品について、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を有することなく、前記1の課徴金対象行為をしていたことから、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第8条第1項第1号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないとは認められない。

(2) 前記(1)の事実によれば、アップドラフトが国庫に納付しなければならない課徴金の額は、景品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの本件商品の売上額に100分の3を乗じて得た額から、同法第12条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り捨てて算出した2864万円である。

よって、アップドラフトに対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。

#### <法律に基づく教示>

##### 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることができる。

(注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。

##### 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。

(注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。

(注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、審査請求をして判決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その判決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただし、正当な理由があるときを除き、その判決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、その判決の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。

- 1 株式会社アップドラフト（以下「アップドラフト」という。）は、仙台市太白区富沢南一丁目2番11号に本店を置き、健康機器等の製造販売業等を営む事業者である。
- 2 アップドラフトは、「滝風イオンメディック」と称する商品（以下「本件商品」という。）を他の事業者を通じて一般消費者に販売している。
- 3 アップドラフトは、本件商品に係るカタログ及び「Ameba」と称するウェブサイトにおける「滝風イオンメディック」と称する自社ブログ（以下「自社ブログ」という。）の表示内容を自ら決定している。

4(1) アップドラフトは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり

ア 令和元年5月1日から同年9月30日までの間に配布したカタログにおいて、別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品は2400万ions/cc以上のマイナスイオンを発生させ、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、6畳から最大80畳までの空間において、浮遊するインフルエンザウイルスを除去及び付着するインフルエンザウイルスを不活化する効果、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオネラ菌を除菌する効果、アレルギー物質、浮遊ウイルスを分解、除去する効果並びに衣類の付着臭を分解、除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

イ 自社ブログにおいて

(ア) 令和元年11月21日に、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品は2400万ions/ccのマイナスイオンを発生させ、本件商品を使用すれば、白血球が大きくなって、免疫力が高くなる効果が得られるかのように示す表示をしていた。

(イ) 令和元年11月27日に、別表3「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品は2400万ions/ccのマイナスイオンを発生させ、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、最大80畳までの空間において、付着臭等を消臭する効果、血圧を下げる効果、電磁波を除去する効果、血流を促進する効果、活性酸素を除去する効果、関節炎を改善する効果、糖尿病を改善する効果、慢性肝炎を改善する効果、慢性腎不全を改善する効果及び動脈硬化症を改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

(ウ) 令和元年12月11日に、別表4「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用すれば、室内に浮遊する花粉を吸着、除去する効果並びに花粉症による涙目、かゆみ、鼻水及びくしゃみを解消する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

- (2) 消費者庁長官は、前記(1)の表示について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）第5条第1号に該当する表示か否かを判断するため、同法第8条第3項の規定に基づき、アップドラフトに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、アップドラフトは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
- (3) アップドラフトは、前記(1)イ(イ)の表示について、「商品の体感、効果には個人差がございます。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記(1)イ(イ)の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

表示内容
<ul style="list-style-type: none"> <li>・『滝風 ION MEDIC』はマイナスイオンの働きに着目しました。大自然さえも上回る2400万ions/cc以上のマイナスイオンを発生。」並びに青い円のイラストと共に、「自然の滝」及び「10,000ions/cc」、「滝風<sup>たき</sup> TAKI ION MEDIC」と記載の青い円のイラストと共に、「24,000,000ions/cc以上」</li> <li>・「また、『滝風 ION MEDIC』は6畳から最大80畳まで対応できます。」</li> <li>・「New インフルエンザウイルスの生存率を下げる事が実証されました。一般社団法人 北里環境科学センター調べ」、「浮遊インフルエンザウイルス除去試験 『滝風イオンメディック』のウイルス除去効果は、作動後15分間で対数減少値を示したことから、ウイルス除去効果があると判断されました。」、「経過時間ごとの浮遊ウイルス感染価（対数値）の変化」との記載と共に、「対照（自然減衰）」及び「滝風イオンメディック」のうち滝風イオンメディックについては、作動時間15分で「ウイルス感染価」が「検出限界値」と記載の箇所に至ったことを示す折れ線グラフ並びに「付着インフルエンザウイルス不活化試験 『滝風イオンメディック』のウイルス不活化効果は、作動後3時間で対数減少値を示したことから、ウイルス不活化効果があると判断されました。」、「時間経過によるウイルス感染価の変化」との記載と共に、「対照（自然減衰）」及び「滝風イオンメディック」のうち滝風イオンメディックについては、作動時間6時間で「ウイルス感染価」が「検出限界値」と記載の箇所に至ったことを示す折れ線グラフ</li> <li>・「滝風イオンメディックが発生させるマイナスイオンは、雑菌を滅菌し、たばこやペット臭などの気になる匂いも取ります。」並びに「たった2時間で除菌！ ※株式会社日本微生物研究所にて試験（平成15年3月24日）」との記載と共に、「黄色ブドウ球菌」、「腸炎ビブリオ菌 サルモネラ菌」及び「レジオネラ菌」が「120分」と記載の箇所で「0」と記載の数値に至ったことを示す折れ線グラフ</li> <li>・「最大80畳までOK！！」</li> <li>・『滝風イオンメディック』は除菌・浄化力が強力です！！、「アレル物質・ウイルス分解・除去 お部屋のアレル物質・浮遊ウイルスを強力に分解・除去しますので、小さなお子様にも安心です。」及び「付着臭分解・除去 衣類に付いたイヤなニオイ成分を分解・消臭。梅雨時の部屋干し臭も吸着しないのでお部屋も、衣類もスッキリ。」</li> </ul>

(別添写し1)

表示内容
<p>「免疫力アップ!」、「免疫力とは体を病気から守る防御システム、その重要な役が血液中の『白血球』です。白血球は血流によって全身を巡回しながら体の中に侵入する異物を飲み込み、異常細胞を処理して病気から体を守る『免疫活動』を日夜行っています!」、「免疫活動を行うのは、白血球の細胞『マクロファージ』『顆粒球』『リンパ球』です。」、「この免疫活動を活発にする期待ができるのが『滝風イオンメディック』なんです!以前、血液画像分析センターで研究していただいた結果、滝風を吸引した後白血球が大きくなることがわかったのです!また自律神経のバランスも正常に落ち着いてくるので自然と白血球の活動が活発になるのです!つまり『免疫力』が高くなるということです。」及び「滝風イオンメディックからは驚異の2400万ion/ccの負電子が大量に発生しており大自然の空気以上の新鮮さをお部屋で体験できます!」</p> <p style="text-align: right;">(別添写し2)</p>

表示内容
<p>・「松野：体感しやすいのは、消臭効果です。アンモニア溶液を染み込ませたティッシュをご用意しましたので、ちょっと嗅いでみてください。 ■■■：うっ！鼻を刺すようなニオイですね。 松野：このティッシュを、『滝風イオン』のイオン風に当てます。（約30秒後）では、もう一度ティッシュを嗅いでみてください。 ■■■：…すごいっ！アンモニア臭が完全になくなっている！多少はニオイが残っているかなと想像していましたが、これは驚きです【実験1】参照。」並びに「【実験1】消臭効果」、アンモニア溶液をスプレーでティッシュに噴霧する画像と共に、「←ティッシュにアンモニア溶液を染み込ませます。」、ティッシュを手にした人物の画像と共に、「↓念のために、ニオイを嗅ぎます。」、「鼻を刺すようなキツイニオイ！」及び「くっさー！！」、ティッシュを本件商品に当てた人物の画像と共に、「↑ティッシュにマイナスイオン風を30秒間当てます。」、ティッシュの臭いを嗅ぐ人物の画像と共に、「←再びティッシュのニオイを嗅ぎます。」及び「くんくん」、ティッシュを手にした人物の画像と共に、「本当にニオイがなくなった！」及び「すごい！！」</p> <p>・「松野：続いて、血圧の変化を見てみましょう。この血圧計を着けてください。手首に巻く簡易タイプなので、健康診断で使う腕に巻くタイプと比べて、ちょっと数値が高く出やすいので、驚かないでくださいね。…上が194で、下が139ですね。 ■■■：あれ、ちょっと緊張しているのかな。確かに高めに出来ますね…（苦笑）。 松野：では、イオン風を吸ってください。（30分ほど、イオン風を吸う）では、もう一度測ってみましょう。…上が171で、下が115。2割弱落ちましたね【実験2】参照。 ■■■：ただ呼吸していただけなのに、不思議ですね…。いろいろと伺いたいことがありますが、今は我慢します（笑）。」及び「【実験2】血圧降下効果」、血圧計を手首に巻いた人物の画像と共に、「マイナスイオンによる血圧降下効果を見るために、手首に巻くタイプの血圧計を使用しました。」、「吸う前」と記載した血圧計の画像と共に、「上が194で、下が139でした。対談で緊張されているのか、ちょっと高めでした。」、「吸った後」と記載した血圧計の画像と共に、「30分間ほどマイナスイオン風を吸った後、再計測。 上が171、下が115まで血圧が下がりました」</p> <p>・「松野：はい（笑）。続いて、マイナスイオンによる電磁波への作用をご覧ください。ここに電磁波検知器とノートパソコンを用意しました。電源を入れなくても、コンセントにつなぐと、検知器から検知音が鳴ります。『滝風イオン』本体も同様です。 ■■■：はい。 松野：そこで、『滝風イオン』でマイナスイオンを発生させると、検知器は…。 ■■■：検知音が鳴りやみましたね。これはスゴイ！というより、本当に不思議ですねえ…【実験3】参照。」並びに「【実験3】電磁波除去」、本件商品、ノートパソコン及び電磁波検知器を手にした人物の画像と共に、「ノートパソコンに電磁波検知器を近づけると… ↓ ピッピッピッ」、「電源が入っていなくても、コンセントが繋がっていれば、ノートパソコンや『滝風イオンメディック』に電磁波検知器を近づけると『ピッピッ』と検知音が鳴りま</p>

す。」、並びにスイッチを入れた本件商品、ノートパソコン及び電磁波検知器を手にした人物の画像と共に、『滝風イオンメディック』の電源を入れた途端に ↓・・・、「マイナスイオンの生成を始めると、ノートパソコンや『滝風イオンメディック』本体に検知器を近づけても、検知音が鳴らなくなりました。」

- ・「【消臭効果】…マイナスイオンには、ニオイ成分を分解する作用があります。アンモニア溶液が染み込んだティッシュにマイナスイオンを当てたことで、ニオイ成分が分解、消臭されたというわけです。」
- ・「【血圧降下効果】…血圧が高くなる原因の一つに、いわゆるドロドロ血液があります。もともと、血液に含まれている赤血球はマイナスの電気を帯び、お互いが反発し合って、くっつくことはありません（つまり、血流が良い状態で保たれる）。ところが、空気環境が悪い場所にいたり、ストレス・疲労を溜めたりすると、次第にプラスに帯電する赤血球が生まれ、お互いがくっつき、ドロドロ血液になってしまいます（これが高血圧の原因となる）。そこで、大量のマイナスイオンを浴びると、プラスの赤血球が、再びマイナスの赤血球に戻り、血流がスムーズになります。その結果、血圧が下がるのです。実際、医師の協力のもとで行なった試験では、被験者全員に、『ドロドロ血液が改善した』という結果が得られました【実験4】参照。」並びに「【実験4】血液サラサラ効果」、「ドロドロ血液の方に、『滝風イオンメディック』で作ったマイナスイオンを10分間吸入してもらい、血液の変化を観察しました。その結果、いずれも血液の状態が改善されて、サラサラ血液に。また、白血球が活性化するなどの変化が確認されました。」、「41歳女性」、「45歳女性」、「30歳男性」、「吸う前」及び「10分後」と記載した血液の状態をそれぞれ示す画像と共に、「赤血球の塊が正常な状態に戻りました！」及び「検査機関：東京八重洲メディカルクリニック（                    医師）」
- ・「【電磁波除去】…2400万個/ccという、超高濃度のマイナスイオンが電磁波に作用したと考えています。付け加えれば、『ドロドロ血液の改善』も、この延長線上にあります。」
- ・本件商品の画像と共に、「80畳まで対応」、「吸うだけで元気になる『空気』を作り出す!」、「一つひとつは力の弱いイオンでも、2400万個/ccという膨大な量になると、素晴らしい還元作用を発揮します。」及び『滝風イオンメディック』の効果 ▶活性酸素の除去 ▶関節炎 ▶糖尿病 ▶慢性肝炎 ▶慢性腎不全 ▶動脈硬化症

(別添写し3)

表示内容
<p>本件商品の画像と共に、「…TAKI ION MEDIC (医療用物質生成器)は常に室内の空気をきれいにし自己の免疫力を高め正常な免疫力を保つことで花粉症の発症を防いだり緩和することが期待できます。また室内に浮遊する花粉を吸着、除去と室内の見張り番に是非1台」、及び本件商品の画像と共に、「滝風イオンメディックの前で呼吸すると涙目 かゆみ 鼻水 くしゃみが解消！」</p> <p style="text-align: right;">(別添写し4)</p>